



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“LOERMA” sh.p.k

Lagja: “Kongresi i Elbasanit”, Rr: “Alush Lleshanaku”, Pallati nr. 34, kati 1, Elbasan.

Numri i Regjistrimit

LT 099

Laborator Testues

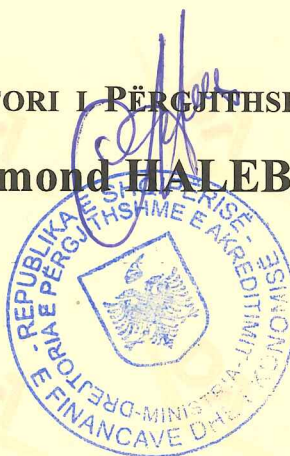
Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 15.01.2020

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 14.01.2024

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 099 15.01.20

Rishikimi 1: 16.07.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 099
Dt- 15.01.2020

Rishikimi 1: 20.04.2022
E vlefshme deri në datën 14.01.2024

“LOERMA”sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e proves	Shënime, ndryshime , rishikime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendnd odhja ku kryhet testi (V)
1	Ujë nëntokësor, ujë i pishëm dhe ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave.	Përcaktimi i pH	4-10	Fotometri/k olorimetri	SSH ISO 10523:2008		PO	/	2
2	Ujëra natyrore, sipërfaqësor e, nëntokësore shkarkime komunale dhe industriale	Përcaktimi i Lëndës në pezulli	≥ 2 mg/l	Filtrim me pompë vakumi (klasike)	SSH EN 872:2005		PO	/	2
3	Ujëra natyrore, sipërfaqësor e, nëntokësor edhe shkarkime industriale	Përcaktimi i nevojës biologjike për oksigen (BOD ₅)	6.00- 250 mg/l	Respirometr i	ISO 5815-2:2009		PO	/	2
4	Shkarkime industriale Ujra të zeza	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigen COD	25 - 1500 mg/l	Fotometri/k olorimetri	LOERMA PT017-001-COD		PO	/	2
5	Ujë nëntokësor; Ujë i pishëm dhe sipërfaqësor ; Ujë burimi dhe ujë pusi; Ujë mineral; Ujra të zeza dhe industriale.	Përcaktimi i Nitratit (NO ₃ ⁻)	0.10- 25.00 mg/l	Fotometri/k olorimetri	LOERMA PT017-001-NO ₃		PO	/	2
6	Ujë nëntokësor dhe sipërfaqësor Ujë deti; Ujë i pishëm; Ujra të zeza;	Përcaktimi i Fosforit Total (P _T)	0.05- 5.00 mg/l	Fotometri/k olorimetri	LOERMA PT017-001-P		PO	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



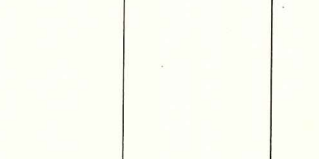


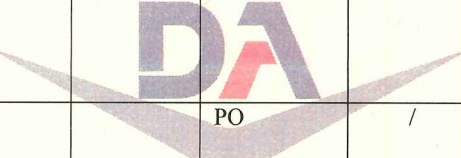

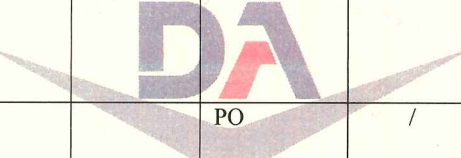
LT 099
Dt- 15.01.2020

Rishikimi 1: 20.04.2022
E vlefshme deri në datën 14.01.2024

“LOERMA”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji i detit; Ujë i pishëm; Ujë industrial; Ujra të zeza dhe ujra të filtruar	 Përcaktimi i Kromit Total (Cr)	0.05-2.00 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Cr		PO	/	2
8	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji i detit; Ujë i pishëm Ujë industrial Ujra të zeza dhe ujra të filtruar	 Përcaktimi i Kromit valent (Cr, VI)	0.010-6.69 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Cr		PO	/	2
9	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe uji i detit; Ujë i pishëm; Ujra të zeza dhe ujra të filtruar; Ushqime.	 Përcaktimi i Hekurit (Fe)	0.010-5.00 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Fe		PO	/	2
10	Ujë nëntokësor dhe ujë sipërfaqësor; Ujë i pishëm; Ujë industrial; Ujra të zeza dhe ujra të filtruar	 Përcaktimi i Nikelit (Ni)	0.02-5.00 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Ni		PO	/	2
11	Ujë nëntokësor, sipërfaqësor dhe ujë i detit; Ujë i pishëm;	 Përcaktimi i Bakrit (Cu)	0.05-8.00 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Cu		PO	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 099
Dt- 15.01.2020

Rishikimi 1: 20.04.2022

E vlefshme deri në datën 14.01.2024

“LOERMA”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujra të zeza dhe të filtruar								
12	Ujin nëntokësor dhe sipërfaqësor ; Ujin e pishëm dhe ujin mineral; Ujin industrial; Ujrat e zeza dhe të filtruar; Lumin e kanalizimeve	Përcaktimi i Plumbit (Pb)	0.01-5.00 mg/l	Fotometri/kolorimetri	LOERMA PT017-001-Pb		PO	/	2
13	Ajër në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0-4000 ppm	Elektrokimi ke	SSH EN 45544-1:2015		PO	/	1
14	Ajër në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	0-2500 ppm	Elektrokimi ke	SSH EN 45544-1:2015		PO	/	1
15	Ajër në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	0-1000 ppm	Elektrokimi ke	SSH EN 45544-1:2015		PO	/	1
16	Ajër në vëndin e punës dhe mjedise të mbyllura	Përcaktimi i Pluhurave në ajër,	0.001-25.000 mg/m ³	Elektrokimi ke	SSH EN 12341:2014		PO	/	1
17	Ajër në Mjedis	Përcaktimi i monoksidit të karbonit CO	0-4000 ppm	Elektrokimi ke	EN 50543:2011		PO	/	1
18	Ajër në Mjedis	Përcaktimi i dioksidit të squfurit SO ₂	0-2500 ppm	Elektrokimi ke	ISO 6767:2000		PO	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 099
Dt- 15.01.2020

Rishikimi 1: 20.04.2022
E vlefshme deri në datën 14.01.2024

“LOERMA”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

19	Ajër në Mjedis	Përcaktimi i dioksidit të azotit NO ₂	0-1000 ppm	Elektrokimike	ISO 6768:2000	PO	/	1
20	Ajër në Mjedis	Përcaktimi i Pluhurave ajër,	0.001-25.000 mg/m ³	Gravimetrike	SSH EN 12341:2014	PO	/	1
21	Ajër në mjedis	Përcaktimi i nivelit të zhurmës mjedis	20-143 dB	Matje elektroakustike zhurmës	SSH ISO 1996-2:2017	PO	/	1
22	Ajër në vendin e punës	Niveli i zhurmës vëndin e punës	20-143 dB	Metodë inxhinierike	SSH EN ISO 9612:2009	PO	/	1
RI 23	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi i Oksigjen	0.5-12 mg/l	Fotometri	DIN EN 25813-1992			0
R1 24	Për të gjithë llojet e ujit me DO mbi 0.2 mg/l	Përcaktimi i Oksigjenit të tretur	≥ 8.0 mg/l	Fotometri	ISO 5813:1983			0
R1 25	Të gjithë llojet e ujit	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	2500μS cm ⁻¹ në 20 °C	Elektrokimike	ISO 7888: 2017			0
R1 26	Ujë pishëm, pishinë, ujra të pastruara apo të dizinfektuara	Zbulimi dhe numerimi i enterokokeve intestinale	0-100 cfu per 100 ml	Teknika e filtrimit me membranë	ISO 7899-2 :2000			0
R1 27	Ujë pishëm ambalazhuar, ujë pishinë dhe ujra të përdorura nga njerzit	Zbulimi dhe numerimi i Pseudomonas aeruginosa	0-100 cfu per 100 ml	Teknika e filtrimit me membranë	ISO 16266:2006			0
R1 28	Për të gjithë llojet e ujit por sidomos për ujin e pishëm	Numerimi i Clostridium perfringens	0-100 cfu per 100 ml	Teknika e filtrimit me membranë	ISO 14189:2013			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 099
Dt- 15.01.2020

Rishikimi 1: 20.04.2022
E vlefshme deri në datën 14.01.2024

“LOERMA”sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 29	Ujë pishëm, ujë pshine, ujë nga impiantet e trajtimit të ujit të pishëm	Numerimi i E. colit dhe bakteve koliforme	0-100 cfu per 100 ml	Teknika e filtrimi me membranë	ISO 9308-1:2014/Amd 2016				0
R1 30	Në të gjithë llojet e ujit për konsumuar nga njeriu, uji i ambalazhuar dhe ujra minerale natyrale	Numerimi i mikroorganizmave te kultivueshem- Numri i kolonive ne pjate në 22 °C dhe 36 °C	>1 cfu ml	-Teknika e numerimit ne pjate	ISO 6222:1999				0

Drejtuesi i laboratorit: Shpresa Banja

Menaxheri i cilesie: Fuat Banja

Tel: 0692046660

Email: banja.ermal@gmail.com

Adresa: Lagjja: "Kongresi i Elbasanit", Rr: "Alush Lleshanaku", Pallati nr. 34, kati 1, Elbasan.

Drejtore i Përgjithshëm
Armond HALEBI



Rishikimi 1: 20.04.2022 Zgjerim i fushës së Akreditimit.
Rishikimi 0: 15.01.2020 Akreditim fillestar.

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325